

**MICROBIX**

**REDx™ FLOQ®**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control**



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4Z 1P3

**Cat#: RED-S-19-M1**

FLOQ® is a trademark of Copan Italia Spa



OBELIS S.A.  
Bd. General Wahis, 53  
1030 Brussels  
Belgium  
+ 32 2 732 59 54  
[mail@obelis.com](mailto:mail@obelis.com)

### About this package insert

Thank you for your interest in this REDx™ quality control product.

This package insert consists of two pages.

- The first page contains the product name and an explanation of the symbols used on the labeling.
- The second page contains the complete package insert text.

If the package insert you view or print does not contain two pages, or if you experience any problems, please email us at [customer.service@microbix.com](mailto:customer.service@microbix.com).

By phone: US customers call +1-800-794-6694; International customers call collect +1-905-361-8910.

A printed package insert will be sent to you upon request.

P/N RED-S-19-M1.5R0

### Explanation of symbols used in Microbix product labeling



Upper limit  
of temperature



Temperature  
limitation



*In Vitro* Diagnostic  
Medical Device



Single-use only



Positive control



Use By



"Caution, consult  
accompanying documents"



Catalogue  
number



Batch code



Manufacturer



**WARNING: THESE REAGENTS MUST NOT BE SUBSTITUTED FOR THE MANDATORY POSITIVE AND NEGATIVE SAMPLE REAGENTS PROVIDED WITH MANUFACTURED TEST KITS.**



**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control**

**FOR IVD USE.**

**INTENDED USE**

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is a desiccated, unassayed control intended to monitor laboratory testing performance, procedures, and workflow with nucleic acid tests (NATs) that detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, and/or Respiratory Syncytial Virus in human nasopharyngeal, oropharyngeal, nasal mid-turbinate, anterior nares and lower respiratory samples, collected on swabs.

**PRODUCT DESCRIPTION**

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is formulated with inactivated whole-genome SARS-CoV-2 cDNA and inactivated native Influenza A, Influenza B, and Respiratory Syncytial Virus. REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control can be utilized as an external sample to monitor the process of respiratory virus nucleic acid detection assays, including sample extraction and purification, amplification, and detection<sup>1</sup>.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control does not have an assigned value ("unassayed"). Laboratories are required to establish an acceptance range for each lot of REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control with all assay procedures that the control is intended to be used with, prior to routine use in the laboratory<sup>2,3</sup>.

**PRINCIPLES OF THE PROCEDURE**

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is designed as an external independent sample for use with laboratory testing of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, and/or Respiratory Syncytial Virus nucleic acid targets, according to ISO 15189 and CLIA regulations.

**REAGENTS**

Cat. No RED-S-19-M1; 1 swab containing inactivated Influenza A, Influenza B, Respiratory Syncytial Virus, and whole-genome SARS-CoV-2 cDNA.

**LIMITATIONS OF THE PROCEDURE**

REDx™ CONTROLS MUST NOT BE SUBSTITUTED FOR THE POSITIVE AND NEGATIVE CONTROL REAGENTS PROVIDED WITH THE MANUFACTURED TEST KITS.

TEST PROCEDURES and INTERPRETATION OF RESULTS provided by manufacturers of test kits must be followed closely.

Deviations from procedures recommended by test kit manufacturers may produce unreliable results.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control DOES NOT HAVE AN ASSIGNED VALUE and may not be suitable for use with all respiratory viral test kits and procedures. Procedures for implementing a quality assurance program and monitoring test performance on a routine basis must be established by each individual laboratory. Each laboratory should establish its own range of acceptable values<sup>2,3</sup>.

Samples are not calibrators and should not be used for assay calibration.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is recommended for use with NATs only.

Adverse shipping and storage conditions or use of outdated samples may produce erroneous results. REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control evaluates only the PCR steps of the RT-PCR methods for detection of SARS-CoV-2.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control might not be suitable for NATs without an extraction step.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS**

*For IVD use.*

**For Professional and Trained Laboratory Personnel Use Only**

**Safety Precautions**

1. Raw material used for REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control preparation is inactivated.
2. Use Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended universal precautions for handling the samples and human specimens<sup>4</sup>.
3. REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control must be disposed of by following RCRA ID#D001 guidelines for ignitable waste<sup>5</sup>.
4. Keep REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control pouch closed when not in use.

**HANDLING PRECAUTIONS**

1. Do not use controls beyond the expiration date.
2. Avoid contamination of controls when opening the swab pouches.

**STORAGE INSTRUCTIONS**

Store REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control at 2-30°C until use. Once opened, REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control should not be reused.

**MATERIALS PROVIDED**

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control – 1 swab

**MATERIALS REQUIRED, BUT NOT PROVIDED**

Refer to the instructions supplied by the manufacturer of the test kit to be used.

**PROCEDURE**

When including the REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control in a test run, the exact same procedure for unknown specimens collected on a swab must be used. Refer to the manufacturer's supplied instructions for use provided with the respiratory viral test kit.

1. Elute the REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control by referring to the preferred technique and volumes described in the assay instructions for use (usually 1-3 mL).
2. Use 100-1000 µL from the eluted swab REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control for the nucleic acid extraction step.
3. After extraction, proceed with the NAT by using the eluted nucleic acid test volume specified in the assay instruction for use (usually 5-20 µL from the eluted purified nucleic acid volume).

**NOTE: Controls must NOT be substituted for the internal kit positive and negative controls.**

As the REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control does not have an assigned value, the laboratory must establish an acceptance range for each lot of the REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control.

**TROUBLESHOOTING**

When REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control results are outside of the established laboratory acceptance range for internal controls, it may be an indication of unsatisfactory test performance.

Possible sources of error include deterioration of test kit reagents, operator error, faulty performance of equipment, or contamination of reagents; internal laboratory procedures should be followed.

**REFERENCES**

1. *Accurate Results in the Clinical Laboratory 2013*, ISBN: 978-0-12-415783-5
2. Kinns H, Pitkin S, Housley D, et al. *J Clin Pathol* 2013;66:1027-1032.
3. *Statistical Quality Sample for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline— Second Edition*. NCCLS document C24-A2, 1999.
4. *CDC Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings*. *MMWR* 36 (suppl. 2), 1987.
5. *Treatment standards for hazardous waste; 40 CFR 268.40 Subpart D. D001: Ignitable characteristics of waste*.

**For assistance, contact Microbix Technical Support at +1-905-361-8910.**



P/N RED-S-19-M1.5R0  
17 November, 2021



265 Watline Ave.  
Mississauga, ON  
Canada L4Z 1P3  
Tel. 905-361-8910  
Fax 905-361-8911  
microbix.com



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control**

**Product Information**

Product Name	REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control
Catalogue Number	RED-S-19-M1
Strain/Cell line	<i>Influenza A/H1N1 Subtype; Influenza B/Hong Kong; Human respiratory syncytial virus, long strain; SARS-CoV-2 whole genome cDNA (NC_045512)</i>
Lot number	19M10013A9
Analyte Value	Unassayed. Value not assigned by the manufacturer
Product Description	Unassayed qualitative positive control for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV
Elution Volume	1-3 mL
Storage conditions	2-30°C
Expiry Date	08 Jun 2027
Intended Use	For <i>In Vitro</i> Diagnostic Use

**Quality Control Information**

Test method	Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Test Result	Observed Result
SARS-CoV-2	Positive
Influenza A	Positive
Influenza B	Positive
RSV	Positive
Inactivation	Inactivated

This product is an unassayed control. The reported QC information is not intended to represent product specifications in any commercial or lab developed test. The laboratory should establish its own analyte value and ranges.



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario, L4Z 1P3



Obelis S.A.  
Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels  
Belgium



Information



Please ensure that your institution is consulted before recycling an item.

swab



pouch




R-Biopharm AG  
An der neuen Bergstraße 17  
64297 Darmstadt, Germany

Quality Assurance Signature: *mei*

Date: 27 May, 2026



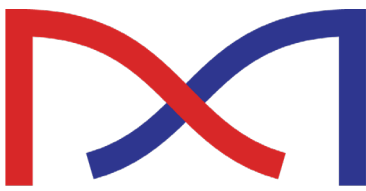

**MICROBIX**



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4Z 1P3

**REDx™ FLOQ®**

**Contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de  
SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™**

**N° de cat. : RED-S-19-M1**

FLOQ® est une marque commerciale de Copan Italia Spa

### À propos de cette notice d'accompagnement

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit de contrôle qualité REDx™. La présente notice d'accompagnement comporte deux pages.

- La première page contient le nom du produit et une explication des symboles utilisés sur l'étiquette.
- La deuxième page contient le texte complet de la notice d'accompagnement du produit.

Si la notice que vous consultez ou imprimez ne contient pas deux pages, ou s'il y a le moindre problème, veuillez nous envoyer un courriel à [customer.service@microbix.com](mailto:customer.service@microbix.com).

Par téléphone : depuis les États-Unis, composez le +1 800 794-6694 ; depuis l'étranger, l'appel est à frais virés au +1 905 361-8910.

Une notice papier vous sera envoyée sur demande.



OBELIS S.A.  
53, bd Général Wahis  
1030 Bruxelles  
Belgique  
+ 32 2 732 59 54  
[mail@obelis.com](mailto:mail@obelis.com)

P/N RED-S-19-M1.5R0

### Explication des symboles utilisés dans l'étiquetage des produits Microbix



Limite supérieure  
de température



Seuil de température



Dispositif médical de  
diagnostic in vitro



Usage unique



Contrôle positif



À utiliser avant



« Attention, veuillez lire les  
documents d'accompagnement. »



Numéro de catalogue



Code du lot



Fabricant



**AVERTISSEMENT : CES RÉACTIFS NE DOIVENT PAS REMPLACER LES RÉACTIFS POUR ÉCHANTILLONS POSITIFS ET NÉGATIFS OBLIGATOIRES FOURNIS AVEC LES TROUSSES DE TEST FABRIQUÉES.**



## Contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™

### POUR DES DIAGNOSTICS IN VITRO.

#### UTILISATION PRÉVUE

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B FLOQ® de REDx™ est un contrôle déshydraté, non testé, destiné à surveiller les performances des tests de laboratoire, les procédures et le flux de travail avec les tests d'amplification des acides nucléiques (NAT) qui détectent le SARS-CoV-2, la grippe de type A, la grippe de type B et/ou le virus respiratoire syncytial dans les échantillons humains nasopharyngés, oropharyngés, du cornet nasal, des narines antérieures et des voies respiratoires inférieures, collectés sur des écouvillons.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ est formulé avec de l'ADNc SARS-CoV-2 à génome entier inactivé et des virus natifs inactivés de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial. Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ peut être utilisé comme échantillon externe pour surveiller le processus des tests de détection des acides nucléiques des virus respiratoires, y compris l'extraction et la purification des échantillons, l'amplification et la détection<sup>1</sup>.

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ n'a pas de valeur attribuée (« non testé »). Les laboratoires sont tenus d'établir une fourchette de tolérance pour chaque lot de contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ avec toutes les procédures de dosage avec lesquelles le contrôle est destiné à être utilisé, avant l'utilisation de routine dans le laboratoire<sup>2,3</sup>.

#### PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ est conçu comme un échantillon externe indépendant destiné à être utilisé dans les tests de laboratoire des cibles d'acide nucléique du SARS-CoV-2, de la grippe de type A, de type B et/ou du virus respiratoire syncytial, conformément aux réglementations ISO 15189 et CLIA.

#### RÉACTIFS

Cat. No RED-S-19-M1 ; 1 écouvillon contenant de l'ADNc inactivé de la grippe A, de la grippe B, du virus respiratoire syncytial et du génome entier du SRAS-CoV-2.

#### LIMITES DE LA PROCÉDURE

LES CONTRÔLES REDx™ NE DOIVENT PAS REMPLACER LES RÉACTIFS TÉMOINS POSITIFS ET NÉGATIFS FOURNIS AVEC LES TROUSSES DE TEST FABRIQUÉES.

LES PROCÉDURES POUR LES TESTS ET L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS fournis par les fabricants de trousse de tests doivent être rigoureusement suivies.

Tout écart par rapport aux procédures recommandées par les fabricants de trousse de tests peut donner des résultats non fiables.

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ N'A PAS DE VALEUR ATTRIBUÉE et peut ne pas être adapté à toutes les procédures et trousse de test viral respiratoire. Les procédures de mise en œuvre d'un programme d'assurance de la qualité et de surveillance régulière du rendement des tests doivent être établies par chaque laboratoire de manière individuelle. Chaque laboratoire doit établir sa propre fourchette de valeurs acceptables<sup>2,3</sup>.

Les échantillons ne sont pas des étalons et ne doivent pas être utilisés pour l'étalonnage des tests.

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ est recommandé pour une utilisation avec les NAT uniquement.

De mauvaises conditions de transport ou de stockage ou l'utilisation d'échantillons périmés peuvent donner des résultats incorrects.

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ évalue uniquement les étapes PCR des méthodes RT-PCR pour la détection du SARS-CoV-2.

Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ peut ne pas convenir pour réaliser des tests d'amplification des acides nucléiques sans avoir procédé au préalable à la phase d'extraction.

#### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

*Pour des diagnostics in vitro.*

Réservé à l'usage exclusif du personnel de laboratoire professionnel et formé

#### Consignes de sécurité

1. La matière première utilisée pour la préparation du contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ est inactivée.
2. Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent de prendre des précautions universelles pour manipuler les échantillons et les prélèvements humains<sup>4</sup>.
3. Le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ doit être jeté en suivant les directives RCRA ID n°D001 pour les déchets inflammables<sup>5</sup>.
4. Garder la pochette de contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

#### PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

1. Ne pas utiliser les contrôles au-delà de la date d'expiration.
2. Éviter la contamination des échantillons lors de l'ouverture des pochettes à écouvillons.

#### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conservez le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ à une température comprise entre 2 et 30 °C jusqu'à son utilisation.

Une fois ouvert, le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ ne doit pas être réutilisé.

#### MATÉRIEL FOURNI

Contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ – 1 écouvillon

#### MATÉRIEL NÉCESSAIRE, MAIS NON FOURNI

Se reporter au mode d'emploi fourni par le fabricant de la trousse de test qui sera utilisée.

#### PROCÉDURE

Lorsque le contrôle négatif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ est utilisé lors d'un test, il doit être soumis exactement à la même procédure que celle utilisée pour les prélèvements inconnus recueillis sur un écouvillon. Se reporter au mode d'emploi fourni par le fabricant avec la trousse de test viral respiratoire.

1. Éluer le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ en se reportant à la procédure recommandée et aux volumes indiqués par les instructions relatives à la réalisation du test (généralement de 1 à 3 mL).
2. Utiliser 100 à 1000 µL de l'écouvillon élué du contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ pour la phase d'extraction de l'acide nucléique.
3. Après l'extraction, effectuer le test d'amplification des acides nucléiques en utilisant le volume de test de l'acide nucléique élué spécifié dans le mode d'emploi du test (généralement 5 à 20 µL du volume d'acide nucléique purifié élué).

**REMARQUE : les contrôles ne doivent PAS remplacer les contrôles positifs et négatifs de la trousse interne.**

Étant donné que le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ n'a pas de valeur attribuée, le laboratoire doit établir une fourchette de tolérance pour chaque lot de contrôles positifs sur écouvillons de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™.

#### RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si les résultats obtenus avec le contrôle positif sur écouvillon pour le dépistage de SARS-CoV-2/Grippe A et B/RSV FLOQ® de REDx™ sont en dehors de la fourchette de tolérance établie par le laboratoire, cela pourrait traduire une réalisation incorrecte du test.

Les causes d'erreur possibles comprennent la dégradation des réactifs de la trousse de test, une erreur de l'opérateur, un mauvais fonctionnement du matériel ou la contamination des réactifs ; les procédures internes du laboratoire doivent être suivies.

#### RÉFÉRENCES

1. *Accurate Results in the Clinical Laboratory 2013*, ISBN: 978-0-12-12-415783-5
2. *Kinns H, Pitkin S, Housley D, et al. J. Clin Pathol 2013;66:1027-1032.*
3. *Statistical Quality Sample for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline— Second Edition. NCCLS document C24-A2, 1999.*
4. *CDC Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings. MMWR 36 (suppl. 2), 1987.*
5. *Treatment standards for hazardous waste; 40 CFR 268.40 Subpart D. D001: Ignitable characteristics of waste.*

Pour toute assistance, veuillez vous adresser au service d'assistance technique de Microbix au +1 905 361-8910.



P/N RED-S-19-M1.5R0  
Le 17 novembre 2021

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

### REDx<sup>™</sup>FLOQ<sup>®</sup> SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control

#### Product Information

Product Name	REDx <sup>™</sup> FLOQ <sup>®</sup> SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control
Catalogue Number	RED-S-19-M1
Strain/Cell line	<i>Influenza A/H1N1 Subtype; Influenza B/Hong Kong; Human respiratory syncytial virus, long strain; SARS-CoV-2 whole genome cDNA (NC_045512)</i>
Lot number	19M10013A9
Analyte Value	Unassayed. Value not assigned by the manufacturer
Product Description	Unassayed qualitative positive control for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV
Elution Volume	1-3 mL
Storage conditions	2-30°C
Expiry Date	08 Jun 2027
Intended Use	For <i>In Vitro</i> Diagnostic Use

#### Quality Control Information

Test method	Xpert <sup>®</sup> Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Test Result	Observed Result
SARS-CoV-2	Positive
Influenza A	Positive
Influenza B	Positive
RSV	Positive
Inactivation	Inactivated

This product is an unassayed control. The reported QC information is not intended to represent product specifications in any commercial or lab developed test. The laboratory should establish its own analyte value and ranges.



Microbix Biosystems Inc.  
 265 Watline Avenue  
 Mississauga, Ontario, L4Z 1P3



Obelis S.A.  
 Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels  
 Belgium



Information




Please ensure that your institution is consulted before recycling an item.



R-Biopharm AG  
 An der neuen Bergstraße 17  
 64297 Darmstadt, Germany

Quality Assurance Signature: *mei*

Date: 27 May, 2026

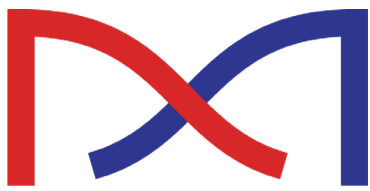

**MICROBIX**



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4Z 1P3

**REDx™ FLOQ®**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV-Abstrich-Positivkontrolle**

**Kat-Nr.: RED-S-19-M1**

FLOQ® ist ein Warenzeichen von Copan Italia Spa

### Über diesen Beipackzettel

Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem REDx™ Produkt zur Qualitätskontrolle. Dieser Beipackzettel umfasst zwei Seiten.

- Auf der ersten Seite finden Sie den Produktnamen und eine Erklärung der für die Kennzeichnung verwendeten Symbole.
- Die zweite Seite enthält den kompletten Text des Beipackzettels.

Wenn die Packungsbeilage, die Sie sich ansehen oder ausdrucken, keine zwei Seiten enthält oder Probleme auftreten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: [customer.service@microbix.com](mailto:customer.service@microbix.com).

Telefonisch: Für US-Kunden +1-800-794-6694; Für internationale Kunden +1-905-361-8910.

Auf Wunsch erhalten Sie eine gedruckte Packungsbeilage.



OBELIS S.A.  
Bd. General Wahis, 53  
1030 Brüssel  
Belgien  
+ 32 2 732 59 54  
[mail@obelis.com](mailto:mail@obelis.com)

P/N RED-S-19-M1.5R0

### Erläuterung der Symbole, die bei der Produktkennzeichnung von Microbix verwendet werden



Temperaturobergrenze



Temperatur-Begrenzung



In-vitro-Diagnostikum



Nur zur einmaligen  
Verwendung



Positivkontrolle



Verwendung durch



""Achtung, Begleitdokumente  
beachten""



Katalognummer



Chargencode



Hersteller

**WARNUNG: DIESE REAGENZIEN DÜRFEN NICHT DURCH DIE VORGESCHRIEBENEN POSITIVEN UND NEGATIVEN PROBENREAGENZIEN ERSETZT WERDEN, DIE MIT DEN HERGESTELLTEN TESTKITS GELIEFERT WERDEN.**



## REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV-Abstrich-Positivkontrolle

### ZUR VERWENDUNG IN DER IN-VITRO-DIAGNOSTIK (IVD).

#### VERWENDUNGSZWECK

Bei der REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV-Abstrich-Positivkontrolle handelt es sich um eine getrocknete, ungetestete Kontrolle, die zur Überwachung der Leistung, der Verfahren und des Arbeitsablaufs von Labortests mit Nukleinsäuretests (NATs) bestimmt ist, die SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und/oder Respiratorische Synzytialviren in menschlichen nasopharyngealen, oropharyngealen, nasalen Mittelturbinaten, anterioren Nasenlöchern und Proben der unteren Atemwege nachweisen, die auf Abstrichen gesammelt wurden.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV wurde mit inaktivierter Ganzgenom-SARS-CoV-2-cDNA und inaktiviertem nativem Influenza A, Influenza B und Respiratorischem Synzytialvirus formuliert. Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV eignet sich als externe Probe zur Überwachung des Prozesses von Nukleinsäure-Nachweissassays für Atemwegsviren, einschließlich Probenextraktion und -reinigung, Amplifikation und Nachweis<sup>1</sup>.

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV hat keinen zugewiesenen Wert („ungetestet“). Für jede Charge der Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV müssen die Laboratorien vor der routinemäßigen Verwendung im Labor einen Akzeptanzbereich für alle Assay-Verfahren bestimmen, für die die Kontrolle verwendet werden soll<sup>2,3</sup>.

#### GRUNDSÄTZE DES VERFAHRENS

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV wurde als unabhängige externe Probe für Labortests von SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und/oder Respiratorischen Synzytialvirus-Nukleinsäurezielen gemäß ISO 15189 und CLIA-Vorschriften entwickelt.

#### REAGENZIEN

Kat. Nr. RED-S-19-M1; 1 Abstrich, der inaktivierte Influenza-A-, Influenza-B-, Respiratorische Synzytial-Viren und SARS-CoV-2 cDNA im Gesamtgenom beinhaltet.

#### VERFAHRENSEINSCHRÄNKUNGEN

REDx™-KONTROLLEN DÜRFEN NICHT DURCH DIE VORGESCHRIEBENEN POSITIVEN UND NEGATIVEN KONTROLLREAGENZIEN ERSETZT WERDEN, DIE MIT DEN HERGESTELLTEN TESTKITS GELIEFERT WERDEN.

Die PRÜFVERFAHREN und die INTERPRETATION DER ERGEBNISSE der Hersteller von Testkits müssen genauestens verfolgt werden.

Abweichungen von den von den Testkitherstellern empfohlenen Verfahren können zu unzuverlässigen Ergebnissen führen.

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV WEIST KEINEN ZUGEWIESENEN WERT AUF und ist möglicherweise nicht für die Verwendung mit allen Testkits und Verfahren für Atemwegsviren geeignet. Verfahren zur Durchführung eines Qualitätssicherungsprogramms und zur routinemäßigen Überwachung der Prüfleistung müssen von jedem einzelnen Labor festgelegt werden. Jedes Labor sollte seinen eigenen zulässigen Wertebereich festlegen<sup>2,3</sup>.

Die Proben sind keine Kalibratoren und sollten nicht für die Assaykalibrierung verwendet werden.

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV wird nur zur Verwendung mit NATs empfohlen.

Ungünstige Transport- und Lagerbedingungen oder die Verwendung veralteter Proben können zu falschen Ergebnissen führen.

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV wertet nur die PCR-Schritte der RT-PCR-Methoden zum Nachweis von SARS-CoV-2 aus.

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV eignet sich unter Umständen nicht für NATs ohne einen Extraktionsschritt.

#### WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik (IVD).

Nur für professionelles und geschultes Laborpersonal geeignet

#### Sicherheitsvorkehrungen

- Das Rohmaterial für die Herstellung der Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV ist inaktiviert.
- Verwenden Sie die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfohlenen universellen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit den Proben und menschlichen Präparaten<sup>4</sup>.
- Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV muss unter Beachtung der RCRA ID#D001 - Richtlinien für entzündliche Abfälle entsorgt werden<sup>5</sup>.
- Bewahren Sie die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV geschlossen auf, wenn Sie ihn nicht verwenden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG

- Verwenden Sie keine Kontrollen nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Vermeiden Sie beim Öffnen der Abstrichbeutel eine Kontamination der Kontrollen.

#### LAGERUNGSANWEISUNGEN

Die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV bis zur Verwendung bei 2-30°C lagern.

Nach dem Öffnen sollte die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV nicht wiederverwendet werden.

#### BEIGESTELLTE MATERIALIEN

Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV - 1 Abstrich

#### ERFORDERLICHE, ABER NICHT BEIGESTELLTE MATERIALIEN

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers des zu verwendenden Testkits.

#### VERFAHREN

Bei der Einbeziehung der Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV in einen Testlauf muss genau dasselbe Verfahren für unbekanntes, mit einem Abstrich entnommene Proben angewendet werden. Die mit dem Testkit für Atemwegsviren mitgelieferte Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

- Eluieren Sie die Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV unter Beachtung der in der Assay-Gebrauchsanweisung beschriebenen bevorzugten Technik und Volumina (in der Regel 1-3 mL).
- Für den Schritt der Nukleinsäureextraktion verwenden Sie 100-1000 µL des eluierten Abstrichs REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV-Abstrich-Positivkontrolle.
- Nach der Extraktion mit NAT unter Verwendung des in der Gebrauchsanweisung des Assays angegebenen eluierten Nukleinsäure-Testvolumens (in der Regel 5-20 µL aus dem eluierten gereinigten Nukleinsäurevolumen) fortfahren.

**HINWEIS: Die Kontrollen dürfen NICHT durch die internen positiven und negativen Kontrollen des Kits ersetzt werden.**

Da es bei der Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV keinen zugewiesenen Wert gibt, ist das Labor verpflichtet, für jede Charge der Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV einen Akzeptanzbereich zu ermitteln.

#### FEHLERBEHEBUNG

Sollten die Ergebnisse der Abstrich-Positivkontrolle REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV nicht innerhalb des vorgegebenen Akzeptanzbereichs des Labors für interne Kontrollen liegen, kann dies ein Hinweis auf eine nicht zufriedenstellende Testleistung sein.

Mögliche Fehlerquellen sind Verschlechterung der Reagenzien des Testkits, Bedienungsfehler, fehlerhafte Leistung der Geräte oder Kontamination der Reagenzien; interne Laborverfahren sollten eingehalten werden.

#### REFERENZEN

- Accurate Results in the Clinical Laboratory 2013*, ISBN: 978-0-12-415783-5
- Kinns H, Pitkin S, Housley D, et al. *J Clin Pathol* 2013;66:1027–1032.
- Statistical Quality Sample for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline— Second Edition*. NCCLS document C24-A2, 1999.
- CDC Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings*. *MMWR* 36 (suppl. 2), 1987.
- Treatment standards for hazardous waste; 40 CFR 268.40 Subpart D. D001: Ignitable characteristics of waste*.

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Microbix unter +1-905-361-8910.



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control**

**Product Information**

Product Name	REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control
Catalogue Number	RED-S-19-M1
Strain/Cell line	<i>Influenza A/H1N1 Subtype; Influenza B/Hong Kong; Human respiratory syncytial virus, long strain; SARS-CoV-2 whole genome cDNA (NC_045512)</i>
Lot number	19M10013A9
Analyte Value	Unassayed. Value not assigned by the manufacturer
Product Description	Unassayed qualitative positive control for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV
Elution Volume	1-3 mL
Storage conditions	2-30°C
Expiry Date	08 Jun 2027
Intended Use	For <i>In Vitro</i> Diagnostic Use

**Quality Control Information**

Test method	Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Test Result	Observed Result
SARS-CoV-2	Positive
Influenza A	Positive
Influenza B	Positive
RSV	Positive
Inactivation	Inactivated

This product is an unassayed control. The reported QC information is not intended to represent product specifications in any commercial or lab developed test. The laboratory should establish its own analyte value and ranges.



Microbix Biosystems Inc.  
 265 Watline Avenue  
 Mississauga, Ontario, L4Z 1P3  
 Obelis S.A.  
 Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels  
 Belgium



Information




Please ensure that your institution is consulted before recycling an item.



R-Biopharm AG  
 An der neuen Bergstraße 17  
 64297 Darmstadt, Germany

Quality Assurance Signature: *mei*

Date: 27 May, 2026

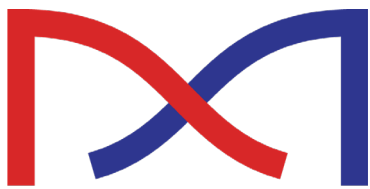

**MICROBIX**



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4Z 1P3

**RED<sup>TM</sup> FLOQ<sup>®</sup>**

**Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx<sup>TM</sup> FLOQ<sup>®</sup>**

**N.º de cat.: RED-S-19-M1**

FLOQ<sup>®</sup> es una marca registrada de Copan Italia Spa.

### Sobre este prospecto

Gracias por su interés en este producto de control de calidad REDx<sup>TM</sup>. Este prospecto consta de dos páginas.

- La primera página contiene el nombre del producto y una explicación sobre los símbolos que se utilizan en el etiquetado.
- La segunda página contiene el texto completo del prospecto.

Si el prospecto que ve o imprime no contiene dos páginas, o si tiene algún problema, envíenos un correo electrónico a [customer.service@microbix.com](mailto:customer.service@microbix.com).

Por teléfono: Los clientes de los EE. UU. deben llamar al +1-800-794-6694; los clientes de otros países deben llamar por cobro revertido al +1-905-361-8910.

Se le enviará un prospecto impreso a pedido.



OBELIS S.A.

Bd. General Wahis, 53  
1030 Brussels  
Belgium  
+ 32 2 732 59 54  
[mail@obelis.com](mailto:mail@obelis.com)

P/N RED-S-19-M1.5R0

## Explicación de los símbolos que se utilizan en el etiquetado de productos Microbix



Límite superior de temperatura



Limitación de temperatura



Dispositivo médico de diagnóstico in vitro



De un solo uso



Control positivo



Usar antes de



"Precaución: Consulte los documentos adjuntos"



Número en el catálogo



Código de lote



Fabricante



**ADVERTENCIA: ESTOS REACTIVOS NO DEBEN SUSTITUIRSE POR LOS REACTIVOS DE MUESTRA POSITIVA Y NEGATIVA OBLIGATORIOS PROVISTOS CON KITS DE PRUEBA FABRICADOS.**



**Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ®**

#### PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO.

#### USO PREVISTO

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/virus sincitial respiratorio (RSV) REDx™ FLOQ® es un control desecado, no sometido a ensayo, destinado a evaluar el rendimiento de los análisis de laboratorio, los procedimientos y el flujo de trabajo con pruebas de ácido nucleico (NAT), que detecta el SARS-CoV-2, la influenza A, la influenza B o el virus sincitial respiratorio en muestras humanas nasofaríngeas, orofaríngeas, de comete nasal medio, de fosas nasales y respiratorias inferiores recogidas en hisopos.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® está formulado con ADN complementario (ADNc) inactivado del genoma completo del SARS-CoV-2 y virus sincitial respiratorio, influenza A e influenza B nativos inactivados. El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® puede utilizarse como muestra externa para supervisar el proceso de los ensayos de detección de ácido nucleico del virus respiratorio, e incluye la extracción, la purificación, la amplificación y la detección de la muestra<sup>1</sup>.

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® no tiene un valor asignado ("no sometido a ensayo"). Se requiere que los laboratorios establezcan un rango de aceptación para cada lote de Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® con todos los procedimientos de ensayo con los que se pretende utilizar el control, antes del uso de rutina en un laboratorio<sup>2,3</sup>.

#### PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® está diseñado como una muestra externa independiente para su uso con análisis de laboratorio de objetivos de ácido nucleico de SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV, de conformidad con las normas ISO 15189 y CLIA.

#### REACTIVOS

N.º de cat. RED-S-19-M1; un hisopo que contiene ADNc inactivado del genoma completo del SARS-CoV-2, influenza A, influenza B y virus sincitial respiratorio.

#### LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

LOS CONTROLES REDx™ NO DEBEN SUSTITUIRSE POR LOS REACTIVOS DE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PROVISTOS CON LOS KITS DE PRUEBA FABRICADOS.

Deben seguirse de cerca los PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA y la INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS provistos por los fabricantes de kits de prueba.

Desviarse de los procedimientos recomendados por los fabricantes de kits de prueba puede producir resultados poco fiables.

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® NO TIENE UN VALOR ASIGNADO y puede no ser adecuado para el uso con todos los kits y procedimientos de pruebas virales respiratorias. Cada laboratorio individual debe establecer procedimientos para implementar un programa de garantía de calidad y supervisar el desempeño de la prueba de manera rutinaria. Cada laboratorio debe establecer su propio rango de valores aceptables<sup>2,3</sup>.

Las muestras no son calibradores y no deben utilizarse para la calibración de ensayos.

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® se recomienda para el uso con NAT únicamente.

Las condiciones adversas de envío y almacenamiento o el uso de muestras obsoletas pueden producir resultados erróneos.

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® evalúa solo los pasos de PCR de los métodos RT-PCR para la detección de SARS-CoV-2.

El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® podría no ser adecuado para las NAT sin un paso de extracción.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

**Para diagnóstico in vitro.**

**Solo para uso profesional y del personal de laboratorio capacitado**

#### Precauciones de seguridad

1. La preparación de la materia prima utilizada para el Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® está inactivada.
2. Siga las precauciones universales recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la manipulación de muestras y materiales de origen humano<sup>4</sup>.
3. El Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® debe eliminarse según las pautas de *Resource Conservation and Recovery Act* (RCRA) n.º de id. D001 para residuos inflamables<sup>5</sup>.
4. Mantenga cerrada la bolsa del Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® cuando no esté en uso.

#### PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

1. No use los controles una vez pasada la fecha de vencimiento.
2. Evite la contaminación de los controles al abrir las bolsas de hisopos.

#### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el Control positivo de hisopado SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® a una temperatura entre 2 °C y 30 °C hasta el momento del uso.

Una vez abierto, el Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® no debe reutilizarse.

#### MATERIALES PROVISTOS

Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ®: 1 hisopo

#### MATERIALES REQUERIDOS, PERO NO PROVISTOS

Consulte las instrucciones provistas por el fabricante del kit de prueba a utilizar.

#### PROCEDIMIENTO

Al incluir el Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® en una prueba, debe utilizarse exactamente el mismo procedimiento para muestras desconocidas recogidas en un hisopo. Consulte las instrucciones de uso provistas por el fabricante que se proporcionan con el kit de prueba viral respiratoria.

1. Para eluir el Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ®, remítase a la técnica y los volúmenes preferidos descritos en las instrucciones de uso del ensayo (normalmente 1-3 ml).
2. Utilice 100-1000 µL del hisopo eluido del Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® para el paso de extracción de ácido nucleico.
3. Después de la extracción, proceda con la NAT; utilice el volumen de NAT eluido especificado en las instrucciones de uso del ensayo (normalmente 5-20 µL del volumen de ácido nucleico purificado eluido).

**NOTA: Los controles NO deben sustituirse por los controles positivos y negativos del kit interno.**

Como el Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® no tiene un valor asignado, el laboratorio debe establecer un rango de aceptación para cada lote de Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ®.

#### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si los resultados del Control positivo de hisopado para SARS-CoV-2/influenza A y B/RSV REDx™ FLOQ® están fuera del rango de aceptación de laboratorio establecido para control interno, esto puede indicar un desempeño insatisfactorio de la prueba.

Entre las posibles causas de error se incluyen el deterioro de los reactivos del kit de prueba, un error del operador, el funcionamiento defectuoso del equipo o la contaminación de los reactivos. Deben seguirse los procedimientos internos del laboratorio.

#### REFERENCIAS

1. *Accurate Results in the Clinical Laboratory 2013*, ISBN: 978-0-12-415783-8
2. Kinns H, Pitkin S, Housley D, et al. *J Clin Pathol* 2013;66:1027-1032.
3. *Statistical Quality Sample for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline- Second Edition*. NCCLS document C24-A2, 1999.
4. *CDC Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings*. *MMWR* 36 (suppl. 2), 1987.
5. *Treatment standards for hazardous waste; 40 CFR 268.40 Subpart D. D001: Ignitable characteristics of waste*.

**Para obtener asistencia, póngase en contacto con el equipo de Soporte Técnico de Microbix al siguiente número telefónico: +1-905-361-8910.**



P/N RED-S-19-M1.5R0  
17 de noviembre de 2021

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control**

**Product Information**

Product Name	REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control
Catalogue Number	RED-S-19-M1
Strain/Cell line	<i>Influenza A/H1N1 Subtype; Influenza B/Hong Kong; Human respiratory syncytial virus, long strain; SARS-CoV-2 whole genome cDNA (NC_045512)</i>
Lot number	19M10013A9
Analyte Value	Unassayed. Value not assigned by the manufacturer
Product Description	Unassayed qualitative positive control for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV
Elution Volume	1-3 mL
Storage conditions	2-30°C
Expiry Date	08 Jun 2027
Intended Use	For <i>In Vitro</i> Diagnostic Use

**Quality Control Information**

Test method	Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Test Result	Observed Result
SARS-CoV-2	Positive
Influenza A	Positive
Influenza B	Positive
RSV	Positive
Inactivation	Inactivated

This product is an unassayed control. The reported QC information is not intended to represent product specifications in any commercial or lab developed test. The laboratory should establish its own analyte value and ranges.



Microbix Biosystems Inc.  
 265 Watline Avenue  
 Mississauga, Ontario, L4Z 1P3  
 Obelis S.A.  
 Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels  
 Belgium



Information




Please ensure that your institution is consulted before recycling an item.



R-Biopharm AG  
 An der neuen Bergstraße 17  
 64297 Darmstadt, Germany

Quality Assurance Signature: *mei*

Date: 27 May, 2026

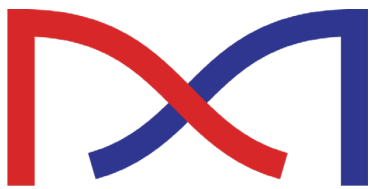

**MICROBIX**



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4Z 1P3

**RED<sup>TM</sup> FLOQ<sup>®</sup>**

**REDx<sup>TM</sup> FLOQ<sup>®</sup> SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control**

**N. cat.: RED-S-19-M1**

FLOQ<sup>®</sup> è un marchio registrato di  
Copan Italia Spa



OBELIS S.A.

Bd. General Wahis, 53

1030 Bruxelles

Belgio

+ 32 2 732 59 54

[mail@obelis.com](mailto:mail@obelis.com)

### Informazioni sul presente foglietto illustrativo

Grazie per l'interesse dimostrato per questo prodotto per il controllo della qualità REDx<sup>TM</sup>. Questo foglietto illustrativo è costituito da due pagine.

- La prima pagina riporta il nome del prodotto e una legenda dei simboli utilizzati sull'etichettatura.
- La seconda pagina riporta il testo completo del foglietto illustrativo.

Se il foglietto illustrativo visualizzato o stampato non contiene due pagine o se si riscontrano problemi, inviare un'e-mail a [customer.service@microbix.com](mailto:customer.service@microbix.com).

Recapiti telefonici: Per clienti statunitensi: +1-800-794-6694; per clienti internazionali (chiamata a carico del destinatario):

+1-905-361-8910.

Su richiesta, verrà inviato il foglietto illustrativo stampato.

P/N RED-S-19-M1.5R0

### Legenda dei simboli utilizzati nell'etichettatura dei prodotti Microbix



Temperatura  
massima



Limitazione della  
temperatura



Dispositivo  
medico-diagnostico *in vitro*



Esclusivamente  
monouso



Controllo positivo



Utilizzare entro



"Attenzione, consultare i  
documenti di accompagnamento"



Numero di  
catalogo



Codice del lotto



Ditta produttrice



**AVVERTENZA: NON SOSTITUIRE QUESTI REAGENTI AI REAGENTI OBBLIGATORI DEI CAMPIONI POSITIVI E NEGATIVI FORNITI CON I KIT DI ANALISI DELLE VARIE DITTE PRODUTTRICI.**



## REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control

### PER USO IVD.

#### DESTINAZIONE D'USO

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control è un controllo non sottoposto a prova essiccato inteso a monitorare prestazioni, procedure e flusso di lavoro delle prove di laboratorio con test dell'acido nucleico (NAT) che rilevano il SARS-CoV-2, l'influenza A, l'influenza B e/o il virus respiratorio sinciziale in campioni umani rinofaringei, orofaringei e appartenenti alle conche nasali intermedie, alle narici e al tratto respiratorio inferiore, raccolti su tamponi.

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control è ricavato dal genoma intero inattivato del SARS-CoV-2 cDNA e virus nativo inattivato dell'influenza A, dell'influenza B e del virus respiratorio sinciziale. REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control può essere utilizzato come campione esterno per monitorare il processo dei test di individuazione dell'acido nucleico dei virus respiratori, compresa l'estrazione e la purificazione del campione, l'amplificazione e il rilevamento.<sup>1</sup>

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control non ha un valore assegnato ("non sottoposto a prova"). Ai laboratori si richiede di stabilire un intervallo di accettabilità per ciascun lotto di REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control con tutte le procedure di analisi con cui il controllo è destinato a essere utilizzato, prima dell'uso di routine in laboratorio<sup>2,3</sup>.

#### PRINCIPI DELLA PROCEDURA

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control è progettato come campione indipendente esterno per l'uso con test di laboratorio sui target di acido nucleico SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e/o il virus respiratorio sinciziale, secondo le normative ISO 15189 e CLIA.

#### REAGENTI

N. cat. RED-S-19-M1; 1 tampone contenente cDNA inattivato di influenza A, influenza B, virus respiratorio sinciziale e un genoma intero del SARS-CoV-2.

#### LIMITI DELLA PROCEDURA

I CONTROLLI REDx™ NON DEVONO ESSERE SOSTITUITI AI REAGENTI DI CONTROLLO POSITIVO E NEGATIVO FORNITI CON I KIT DI ANALISI DELLE VARIE DITTE PRODUTTRICI.

È necessario seguire attentamente le PROCEDURE DI ANALISI e l'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI forniti dalle ditte produttrici dei kit di analisi.

Eventuali deviazioni dalle procedure raccomandate dalle ditte produttrici di kit di analisi possono produrre risultati inaffidabili.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control NON HA UN VALORE ASSEGNATO e potrebbe non essere idoneo all'uso con tutti i kit e le procedure dei test virali respiratori. Ogni laboratorio deve stabilire le procedure per l'implementazione di un programma di garanzia della qualità e il monitoraggio delle prestazioni delle analisi di routine. Ogni laboratorio dovrebbe stabilire il proprio intervallo di accettazione<sup>2,3</sup>.

I campioni non sono calibratori e non devono essere utilizzati per la calibrazione del saggio.

Si raccomanda l'uso di REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control esclusivamente per test dell'acido nucleico.

Condizioni di spedizione e conservazione non idonee o l'uso di campioni obsoleti possono produrre risultati errati.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control viene utilizzato esclusivamente durante le fasi PCR dei metodi RT-PCR per il rilevamento del SARS-CoV-2.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control potrebbe non essere adatto ai test dell'acido nucleico senza fase di estrazione.

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

##### Per uso IVD.

Solo per personale di laboratorio professionista e qualificato

##### Precauzioni di sicurezza

1. La materia prima utilizzata per la preparazione di REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control è inattivata.
2. Durante la manipolazione degli esemplari e dei campioni umani, attenersi alle precauzioni universali raccomandate dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC, Centers for Disease Control and Prevention)<sup>4</sup>.
3. REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control deve essere smaltito in conformità con le linee guida RCRA ID#D001 per i rifiuti infiammabili<sup>5</sup>.
4. Quando il sacchetto contenente REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control non viene utilizzato, deve essere conservato chiuso.

#### PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE

1. Non utilizzare i controlli oltre la data di scadenza.
2. Evitare la contaminazione dei controlli al momento dell'apertura dei sacchetti di tamponi.

#### ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control a una temperatura di 2-30 °C fino al momento dell'uso.

Una volta aperto, REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control non deve essere riutilizzato.

#### MATERIALI FORNITI

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control – 1 tampone

#### MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI

Consultare le istruzioni fornite dalle ditte produttrici dei kit di analisi da utilizzare.

#### PROCEDURA

Quando si include REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control in un ciclo analitico, è necessario utilizzare la stessa procedura impiegata per analizzare gli esemplari sconosciuti raccolti su tampone. Consultare le istruzioni fornite dalla ditta produttrice incluse nel kit per il test virale respiratorio.

1. Eluire REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control facendo riferimento alla tecnica consigliata e ai volumi riportati nelle istruzioni per lo svolgimento delle analisi (di solito 1-3 ml).
2. Utilizzare 100-1000 µl dal tampone eluito di REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control per la fase di estrazione dell'acido nucleico.
3. Dopo l'estrazione procedere con NAT utilizzando il volume di prova dell'acido nucleico eluito specificato nelle istruzioni per lo svolgimento delle analisi (di solito 5-20 µl in volume di acido nucleico purificato eluito).

#### NOTA: NON sostituire i controlli ai reagenti di controllo positivo e negativo del kit interno.

Poiché REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control non ha un valore assegnato, ogni laboratorio deve stabilire un intervallo di accettabilità per ciascun lotto di REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control.

#### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il fatto che i risultati di REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control non rientrino nell'intervallo di accettabilità per i controlli interni può essere indice di inadeguatezza delle prestazioni analitiche.

Tra i possibili motivi di errore vi sono: deterioramento dei reagenti del kit di analisi, errore commesso dal tecnico, malfunzionamento delle apparecchiature o contaminazione dei reagenti; è necessario attenersi alle procedure interne di laboratorio.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. *Accurate Results in the Clinical Laboratory 2013*, ISBN: 978-0-12-415783-5
2. Kinns H, Pitkin S, Housley D, et al. *J Clin Pathol* 2013;66:1027–1032.
3. *Statistical Quality Sample for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline— Second Edition*. NCCLS document C24-A2, 1999.
4. *CDC Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings*. *MMWR* 36 (suppl. 2), 1987.
5. *Treatment standards for hazardous waste; 40 CFR 268.40 Subpart D. D001: Ignitable characteristics of waste.*

Per assistenza, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Microbix al numero +1-905-361-8910.



P/N RED-S-19-M1.5R0  
17 novembre 2021

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control**

**Product Information**

Product Name	REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control
Catalogue Number	RED-S-19-M1
Strain/Cell line	<i>Influenza A/H1N1 Subtype; Influenza B/Hong Kong; Human respiratory syncytial virus, long strain; SARS-CoV-2 whole genome cDNA (NC_045512)</i>
Lot number	19M10013A9
Analyte Value	Unassayed. Value not assigned by the manufacturer
Product Description	Unassayed qualitative positive control for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV
Elution Volume	1-3 mL
Storage conditions	2-30°C
Expiry Date	08 Jun 2027
Intended Use	For <i>In Vitro</i> Diagnostic Use

**Quality Control Information**

Test method	Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Test Result	Observed Result
SARS-CoV-2	Positive
Influenza A	Positive
Influenza B	Positive
RSV	Positive
Inactivation	Inactivated

This product is an unassayed control. The reported QC information is not intended to represent product specifications in any commercial or lab developed test. The laboratory should establish its own analyte value and ranges.



Microbix Biosystems Inc.  
 265 Watline Avenue  
 Mississauga, Ontario, L4Z 1P3  
 Obelis S.A.  
 Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels  
 Belgium



Information




Please ensure that your institution is consulted before recycling an item.



R-Biopharm AG  
 An der neuen Bergstraße 17  
 64297 Darmstadt, Germany

Quality Assurance Signature: *mei*

Date: 27 May, 2026

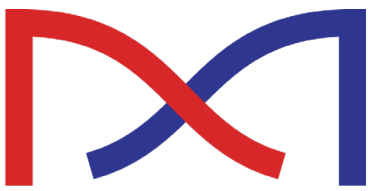

**MICROBIX**



Microbix Biosystems Inc.  
265 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4Z 1P3

**REDx™ FLOQ®**

**REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control**

**Cat#: RED-S-19-M1**

FLOQ® is een handelsmerk van Copan Italia Spa

### Over deze bijsluiter

Bedankt voor uw interesse in dit REDx™-product voor kwaliteitscontrole. Deze bijsluiter bestaat uit twee pagina's.

- De eerste pagina bevat de productnaam en uitleg van de symbolen die op het etiket worden weergegeven.
- Op de tweede pagina staat de volledige tekst van de bijsluiter.

Als de bijsluiter niet bestaat uit twee pagina's, of als u er een probleem mee ervaart, stuur ons dan een e-mail naar [customer.service@microbix.com](mailto:customer.service@microbix.com).

Of neem telefonisch contact op: Klanten in de VS bellen +1-800-794-6694.

Klanten uit andere landen bellen gratis

+1-905-361-8910.

Een gedrukte versie van de bijsluiter zal u worden toegezonden indien u daarom vraagt.



OBELIS S.A.

Bd. General Wahis, 53

1030 Brussel

België

+ 32 2 732 59 54

[mail@obelis.com](mailto:mail@obelis.com)

P/N RED-S-19-M1.5R0

### Uitleg van de symbolen op de etiketten van Microbixproducten



Upper limit Bovengrens van temperatuur



Temperatuurlimiet



In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel



Eenmalig gebruik



Positieve controle



Te gebruiken voor



"Let op, raadpleeg bijbehorende documenten"



Catalogusnummer



Batchcode



Producent



**WAARSCHUWING: DEZE REAGENTIA MOGEN NIET WORDEN VERVANGEN DOOR DE VERPLICHTE POSITIEVE EN NEGATIEVE MONSTERREAGENTIA DIE WORDEN MEEGELEVERD BIJ DE TESTKITS.**



## REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control

### VOOR IVD-GEBRUIK.

#### BEDOELD GEBRUIK

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is een gedroogde, niet-geteste controle die bedoeld is om de laboratoriumprestaties, procedures en workflow te monitoren met nucleïnezuurtests (NAT's) die SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B en/of Respiratoir Syncytiaal Virus detecteren in menselijke nasofaryngeale, orofaryngeale, nasale mid-turbinate, anterior neusgaten en lagere luchtwegen, verzameld op uitstrijkjes.

#### PRODUCTBESCHRIJVING

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is geformuleerd met geïnactiveerd SARS-CoV-2-cDNA voor het hele genoom en geïnactiveerd lokaal Influenza A, Influenza B en Respiratoir Syncytiaal Virus. REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control kan worden gebruikt als externe controle om het proces van nucleïnezuurdetectietests voor respiratoir virus te volgen, waaronder extractie, zuivering, uitbreiding en detectie<sup>1</sup>.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control heeft geen toegewezen waarde ("niet-gekeurd"). Het is vereist dat ieder laboratorium een acceptatiebereik vaststelt voor elke productie van REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control met elke testprocedure die voorafgaand aan elk routinematig gebruik in het laboratorium uitgevoerd moet worden<sup>2,3</sup>.

#### BEGINSELEN VAN DE PROCEDURE

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is ontwikkeld als een extern, onafhankelijk monster voor gebruik bij laboratoriumtests van SARS-CoV-2-nucleïnezuurdoelen, volgens ISO 15189 en CLIA-voorschriften.

#### REAGENTIA

Cat. Geen RED-S-19-M1; 1 schwab met geïnactiveerd Influenza A, Influenza B, Respiratoir syncytiaal Virus en het hele genoom SARS-CoV-2 cDNA.

#### BEPERKINGEN VAN DE PROCEDURE

REDx™ REAGEERMIDDELEN MOGEN NIET WORDEN VERVANGEN VOOR DE POSITIEVE EN NEGATIEVE CONTROLEREAGEERMIDDELEN DIE WORDEN GELEVERD BIJ DE TESTKITS.

TESTPROCEDURES en INTERPRETATIE VAN RESULTATEN geleverd door leveranciers van testkits moeten nauwkeurig gevolgd worden.

Afwijkingen van procedures aanbevolen door producenten van testkits kunnen leiden tot onnauwkeurige resultaten.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 /Flu A&B/RSV Swab Positive Control HEEFT GEEN TOEGEKENDE WAARDE en is mogelijk niet geschikt om met alle -respiratoir virale-testkits en -procedures gebruikt te worden. Procedures voor een kwaliteitscontroleprogramma en het beoordelen van testen op routinematige basis moeten door ieder laboratorium afzonderlijk worden vastgesteld. Elk laboratorium dient zijn eigen waarden van het acceptatiebereik te bepalen<sup>2,3</sup>.

De monsters zijn geen kalibratoren en dienen niet gebruikt te worden als testkalibratie.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control wordt alleen aanbevolen voor gebruik met NAT's.

Onjuiste bewaring, verplaatsing of het gebruik van verouderde monsters kunnen foutieve resultaten opleveren.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control evalueert alleen de PCR-stappen van de RT-PCR-methoden om SARS-CoV-2 te detecteren.

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control is mogelijk niet geschikt voor NAT's zonder extractiestap.

#### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

##### Voor IVD-gebruik.

##### Voor gebruik door professioneel en bevoegd laboratoriumpersoneel

##### Veiligheidsmaatregelen

1. Basismaterialen voor de bereiding van REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 Flu A&B/RSV Swab Positive zijn niet geactiveerd.
2. Gebruik de door de Centers for Disease Control (CDC) aanbevolen universele voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van monsters en menselijk testmateriaal<sup>4</sup>.
3. REDx™ SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control moet worden verwijderd volgens de richtlijn RCRA ID#D001 voor brandbare afvalstoffen<sup>5</sup>.
4. Houd het zakje voor REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control gesloten wanneer het niet in gebruik is.

#### OMGAAN MET VOORZORGSMATREGELEN

1. Voer de controles niet uit als de aanbevolen gebruiksdatum daarvan verlopen is.
2. Voorkom besmetting van monsters bij het openen en sluiten van de zakjes.

#### BEWAARINSTRUCTIES

Bewaar REDx™ SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control tot gebruik op een temperatuur van 2-30°C.

Eenmaal geopend, mag de SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control niet nogmaals gebruikt worden.

#### BESCHIKBARE MATERIALEN

REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control– 1 swab

#### VEREISTE, MAAR NIET BESCHIKBARE MATERIALEN

Raadpleeg de instructies voor de testkit die de leverancier heeft verschaft.

#### PROCEDURE

Als u de REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control in een test gebruikt, moet exact dezelfde procedure worden gevolgd voor onbekende monsters die op een uitstrijkje worden verzameld. Raadpleeg de instructies die door de producent met de respiratoir virale testkit zijn bijgeleverd.

1. Elueer de REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control door de voorkeurstechiek en volumes te raadplegen die beschreven worden in de testinstructies voor gebruik (gewoonlijk 1-3 ml).
2. Gebruik 100-1000 µL van de geëluëerde REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2 /Flu A&B/RSV Swab Positive Control voor de nucleïnezuurextractiestap.
3. Ga na extractie verder met NAT met behulp van het geëluëerde nucleïnezuurtestvolume dat is gespecificeerd in de testinstructie voor gebruik (gewoonlijk 5-20 µL van het geëluëerde zuiverende nucleïnezuurvolumen).

**OPMERKING: Controles mogen NIET worden vervangen door de positieve en negatieve controles in de kit.**

Omdat REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control geen toegewezen waarde heeft, moet het laboratorium voor elke partij REDx™ FLOQ® SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control een acceptatiebereik bepalen.

#### PROBLEEMOPLOSSING

Als de resultaten van REDx™ SARS-CoV-2/Flu A&B/RSV Swab Positive Control buiten het vastgestelde acceptatiebereik vallen voor interne controles, kan dat een teken zijn van een onvoldoende testresultaat.

Mogelijke oorzaken van fouten zijn aantasting van de reageermiddelen van de testkit, een fout van de gebruiker, onjuiste werking van de materialen, vervuiling van de reageermiddelen; interne procedures van het laboratorium moeten worden gevolgd.

#### BRONNEN

1. *Accurate Results in the Clinical Laboratory 2013*, ISBN: 978-0-12-415783-5
2. *Kinns H, Pitkin S, Housley D, et al. J Clin Pathol 2013;66:1027-1032.*
3. *Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline— Second Edition. NCCLS document C24-A2, 1999.*
4. *CDC Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings. MMWR 36 (suppl. 2), 1987.*
5. *Treatment standards for hazardous waste; 40 CFR 268.40 Subpart D. D001: Ignitable characteristics of waste.*

Voor hulp neemt u contact op met Microbix Technical Support via +1-905-361-8910.



P/N RED-S-19-M1.5R0  
17 november, 2021

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

### REDx<sup>™</sup>FLOQ<sup>®</sup> SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control

#### Product Information

Product Name	REDx <sup>™</sup> FLOQ <sup>®</sup> SARS-CoV-2/FluA&B/RSV Swab Positive Control
Catalogue Number	RED-S-19-M1
Strain/Cell line	<i>Influenza A/H1N1 Subtype; Influenza B/Hong Kong; Human respiratory syncytial virus, long strain; SARS-CoV-2 whole genome cDNA (NC_045512)</i>
Lot number	19M10013A9
Analyte Value	Unassayed. Value not assigned by the manufacturer
Product Description	Unassayed qualitative positive control for the detection of SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV
Elution Volume	1-3 mL
Storage conditions	2-30°C
Expiry Date	08 Jun 2027
Intended Use	For <i>In Vitro</i> Diagnostic Use

#### Quality Control Information

Test method	Xpert <sup>®</sup> Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
Test Result	Observed Result
SARS-CoV-2	Positive
Influenza A	Positive
Influenza B	Positive
RSV	Positive
Inactivation	Inactivated

This product is an unassayed control. The reported QC information is not intended to represent product specifications in any commercial or lab developed test. The laboratory should establish its own analyte value and ranges.



Microbix Biosystems Inc.  
 265 Watline Avenue  
 Mississauga, Ontario, L4Z 1P3



Obelis S.A.  
 Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels  
 Belgium



Information



Please ensure that your institution is consulted before recycling an item.



R-Biopharm AG  
 An der neuen Bergstraße 17  
 64297 Darmstadt, Germany

Quality Assurance Signature: *mei*

Date: 27 May, 2026